

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEL SITO WEB

aggiornato al 30 maggio 2025

Keter si impegna a promuovere l'accessibilità digitale per le persone con disabilità. Stiamo costantemente migliorando l'esperienza utente per tutti i visitatori del sito e applicando gli standard di accessibilità pertinenti. Come parte di questo impegno, questo sito è stato esaminato da sviluppatori software e modificato per soddisfare gli standard stabiliti dalle WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines 2.2) al livello AA. Le linee guida WCAG 2.2 AA coprono una vasta gamma di raccomandazioni per rendere i contenuti Web più accessibili. Le linee guida WCAG 2.2 AA includono dettagli specifici su come sviluppare contenuti Web accessibili. Questa dichiarazione certifica che sono stati rispettati i criteri di successo dettagliati dalle WCAG. Inoltre, come parte del nostro impegno per l'accessibilità, controlliamo frequentemente il nostro sito internamente e/o tramite terzi, utilizzando tecnologie assistive come software di lettura dello schermo (ad esempio NVDA, JAWS, ecc.).

Saranno di seguito descritte le modifiche, presenti e future, suddivise per area di intervento che sono state progettate per il sito in risposta alle esigenze evidenziate.

Cosa sono le linee guida WCAG

Lo standard definisce i requisiti che un sito web deve possedere per ritenersi accessibile, basandosi su quattro principi fondamentali:

Percepibilità: Le informazioni e i contenuti devono essere resi disponibili in modo che siano accessibili a tutti gli utenti, incluse le persone con disabilità sensoriali.

Operabilità: L'interfaccia e la navigazione devono essere utilizzabili anche

senza l'ausilio del mouse, permettendo l'accesso tramite tastiera o tecnologie assistive.

Comprensibilità: I contenuti e le operazioni devono essere espressi in modo chiaro e semplice, per favorire la loro comprensione da parte di tutti gli utenti.

Robustezza: Il sito deve essere compatibile con numerose tecnologie assistive e dispositivi. È quindi essenziale sviluppare un sito web che sia responsive.

Specifiche Tecniche

L'accessibilità di questo sito web si basa sulle seguenti tecnologie per funzionare con la combinazione specifica di browser web e qualsiasi tecnologia assistiva o plugin installato sul tuo computer:

- HTML
- WAI-ARIA
- CSS
- JavaScript

Queste tecnologie sono utilizzate per conformarsi agli standard di accessibilità adottati.

Rispetto del livello di conformità AA delle linee guida WCAG 2.2

Le linee guida WCAG, giunte alla loro formulazione nella versione 2.2, hanno tre 'gradi' di profondità. Lo standard minimo richiesto dalla normativa è quello AA, che assicura una maggiore accessibilità per una vasta gamma di utenti con disabilità, inclusi soggetti con problemi visivi, uditivi, motori e cognitivi. Ecco i passaggi che abbiamo compiuto:

- Stato di partenza: il sito ad oggi 30 maggio 2025, gode di un'eccellente accessibilità. Il test di accessibilità di Google <https://pagespeed.web.dev/>

dà al sito un punteggio di 87, molto vicino alla soglia critica dell'eccellenza di 90.



Accessibilità

Questi controlli mettono in evidenza le opportunità per [migliorare l'accessibilità della tua app web](#). Il rilevamento automatico è in grado di rilevare soltanto un sottoinsieme di problemi e non garantisce l'accessibilità della tua app web, pertanto sono consigliati anche i [test manuali](#).

- Rimozione della barra di ricerca nel menù superiore: la barra è stata rimossa in quanto giudicata superflua e non permetteva l'interazione esclusiva da tastiera, come invece richiesto dalle linee guida WCAG 2.2.
 - Compilazione automatica (predisposta tramite plugin RankMath) di tutti i campi titolo e alt-text delle immagini ove mancanti. Questo permette ai lettori di schermo di 'descrivere' meglio il contenuto delle immagini.
 - Rimozione del link alla home page del pulsante del logo. Risultava troppo piccolo da premere. E' presente comunque la voce a menù principale.
 - Ingrandimento del font del footer, aumento degli interlinea e trasformazione degli header in H2 come richiesto dalla gerarchia WCA.
- Immagine del prima e del dopo:

LEGAL

[Privacy Policy](#)

[Cookie Policy](#)

[Termini e Condizioni d'Uso](#)

[Termini e Condizioni generali di acquisto](#)

P. Iva IT 09090250961

LEGAL

[Privacy Policy](#)

[Cookie Policy](#)


[Termini e Condizioni d'Uso](#)

[Termini e Condizioni generali di acquisto](#)

P. Iva IT 09090250961

Test finale

- Dopo queste modifiche, il punteggio di accessibilità della home page indicato dal suddetto test di Google è di 100, liberamente verificabile online:

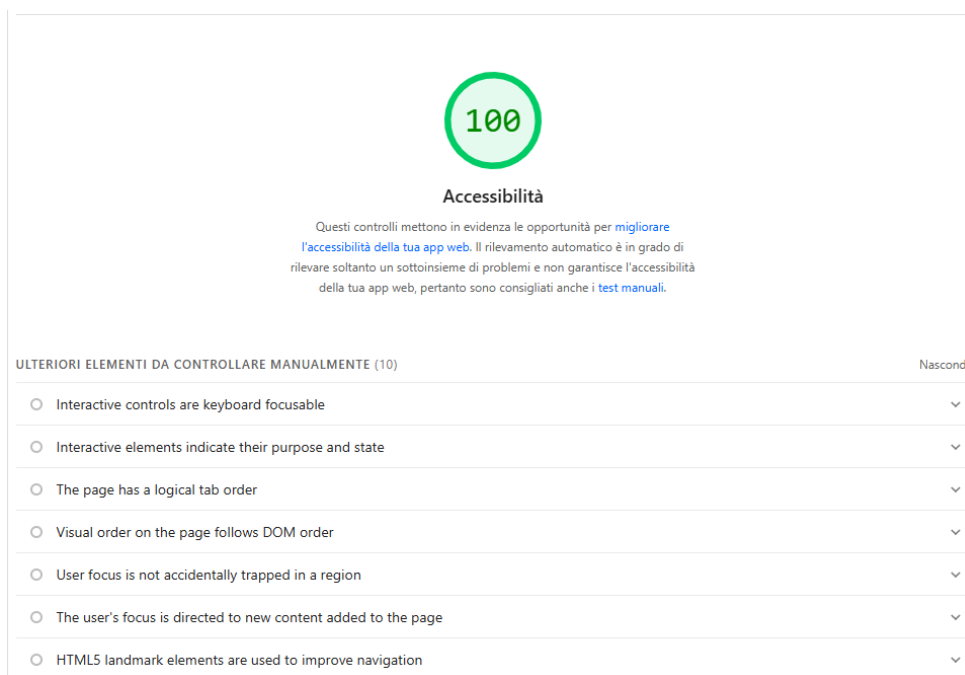

The screenshot shows the Google Lighthouse accessibility score of 100. At the top, a green circle contains the number '100'. Below it, the word 'Accessibilità' is displayed. A paragraph explains that these controls highlight opportunities to improve web app accessibility, but automatic detection is not exhaustive, recommending manual testing. Below this, a table lists 10 manual checks, all of which are passed, indicated by radio buttons.

Accessibilità

Questi controlli mettono in evidenza le opportunità per [migliorare l'accessibilità della tua app web](#). Il rilevamento automatico è in grado di rilevare soltanto un sottoinsieme di problemi e non garantisce l'accessibilità della tua app web, pertanto sono consigliati anche i [test manuali](#).

ULTERIORI ELEMENTI DA CONTROLLARE MANUALMENTE (10)	Nascondi
☐ Interactive controls are keyboard focusable	▼
☐ Interactive elements indicate their purpose and state	▼
☐ The page has a logical tab order	▼
☐ Visual order on the page follows DOM order	▼
☐ User focus is not accidentally trapped in a region	▼
☐ The user's focus is directed to new content added to the page	▼
☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation	▼

Aggiornamento 12/06/2025

- Riformulato il menu principale del sito, rendendo ogni singola voce e sottovoce raggiungibile tramite il focus da tastiera.

- Rese le tab graficate delle pagine delle categorie prodotto:
<https://apmedical.it/prodotti/sharps-containers/> e
<https://apmedical.it/prodotti/waste-containers/> e ovviamente le loro
 corrispettive tradotte invisibili agli screen reader per via della non
 selezionabilità da tastiera.




Al suo post per gli screen reader abbiamo inserito una sezione nello stesso punto della pagina interamente composta da link diretti alle pagine prodotto.

Eventuali contenuti non accessibili

- In data 30 maggio 2025, le pagine contenenti le descrizioni dei nostri prodotti hanno un punteggio di accessibilità di 95. Le problematiche secondo Pagespeed riguardano: rapporto di contrasto tra colore del breadcrumb e dello sfondo insufficiente, elementi intestazione segnati come h4 invece che h3 o h2 e testo alternativo delle ultime immagini ridondante con il titolo dell'immagine. Si tratta di elementi non compromettenti la fruizione della pagina a nostro avviso, e difficoltosi da correggere per via dell'elevato numero di pagine prodotto nel sito.
- Il cookie banner del plugin per la privacy da noi utilizzato, CookieBot, ha degli attributi ARIA che non corrispondono ai rispettivi ruoli secondo la segnalazione di Lighthouse:

Ogni elemento role ARIA supporta un determinato sottoinsieme di attributi aria-*. Se non dovessero corrispondere, gli attributi aria-* non saranno considerati validi. [Scopri come far corrispondere gli attributi ARIA ai relativi ruoli.](#)

Elementi respinti

	Consenso <pre></pre>
	Dettagli <pre></pre>
	Informazioni sui cookie <pre></pre>

Su questo Apmedical non ha possibilità di intervento, ma deve attendere l'accorgimento da parte del plugin stesso. In ogni caso questo non incide sulla fruizione del banner da parte dei lettori di schermo.

Apmedical si impegna comunque a mantenere la massima accessibilità al proprio sito. Nel caso riscontri un contenuto non accessibile, o tu abbia un qualsiasi problema di accessibilità, ti invitiamo a contattarci in merito – vedi prossima sezione.

Contatti di supporto per eventuali segnalazioni

- Accogliamo con favore il tuo feedback riguardo all'accessibilità di Keter.com. Ti preghiamo di farci sapere se incontri barriere di accessibilità: puoi contattarci con il modulo dedicato nella pagina <https://apmedical.it/contatti/> oppure all'indirizzo apmedical@keter.com o al numero +39 0422 745900.
- Ci impegniamo a rispondere ai feedback entro 5 giorni lavorativi.

Ultima revisione: 12 giugno 2025

